





Comment bien faire un test de glycémie




1. Lavez-vous les mains et essuyez-les avant d'effectuer une mesure de glycémie.

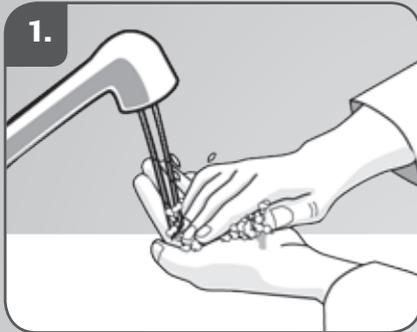

2. Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées. Retirez une bandelette réactive du tube, puis refermez-le directement.

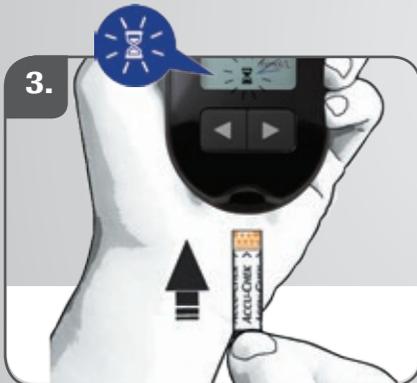

3. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur dans le sens de la flèche, jusqu'au signal sonore. Après la brève apparition d'un sablier, un deuxième signal sonore s'entend et le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.

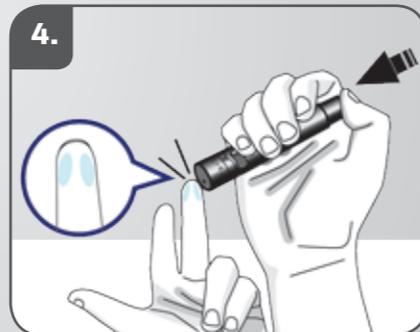

4. Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'au bout.



Vidéos de formation sous: www.accu-check.ch



Accu-Chek Aviva pour une meilleure qualité de vie.

Optez pour des résultats fiables, optez pour Accu-Chek Aviva.



1. Strip Size Handling Report, SMBG Systems - the influence of test strip size on the ease of use in self-monitoring of blood glucose. IDI-1121-RM. Data on file. 2. Westhoff A, Schmid C, Zech D, et al. Relationship between size of test strip and handling of test strips for self-monitoring of blood glucose. Poster presented at: the 47th Annual Meeting of the German Diabetes Society (DDG), May 2012, Stuttgart, Germany. 3. Kocher S, Tshiananga JKI, Koubek R. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. J Diabetes Sci Technol. 2008;3(5):1136-1143. 4. Data on file. ISO 15197:2013, in vitro diagnostic test systems requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus include tighter requirements for accuracy and new criteria for hematocrit and other interferences. 5. Freckmann G, Schmid C, Baumstark A, Pleus S, Link M, Haug C. System Accuracy Evaluation of 43 Blood Glucose Monitoring Systems for Self-monitoring of Blood Glucose according to DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(5): 1060 - 75. 6. Baumstark A, Pleus S, Schmid C, Link M, Haug C, Freckmann G. Lot-to-Lot Variability of Test Strips and Accuracy Assessment of Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose according to ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(5): 1076 - 86. 7. Freckmann G, et al. "System Accuracy Evaluation of 27 Blood Glucose Monitoring Systems According to DIN EN ISO 15197". DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 12, Number 3, 2010. 8. Freckmann G, et al. "System Accuracy Evaluation of 3 Blood Glucose Monitoring Systems according to EN ISO 15197", poster presentation at the DIM 2011, San Francisco (FREC 1125D). 9. Kristensen et al. Standardized Evaluation of Nine Instruments for Self-Monitoring of Blood Glucose. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 10, Number 6, 2008. TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 10, Number 6, 2008. 10. Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Houweling ST, Van de Laar FA, Bilo HJ, Holleman F, Burgers JS, Wiersma TJ, Janssen PGH. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56(10):512-525.

07.390.483.001 / 08-14 / 3000F

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK FASTCLIX et ACCU-CHEK SMART PIX sont des marques de Roche.
© 2014 Roche Diagnostics.

www.accu-check.ch
Hotline diabète: 0800 803 303

Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz




Accu-Chek Aviva Simple, fiable, exact.



Accu-Chek Aviva Il n'y a pas plus simple.

Les diabétiques devraient mesurer leur glycémie à intervalles réguliers. Accu-Chek Aviva associe un contrôle commode à des résultats précis et contribue ainsi à diminuer le risque de complications liées au diabète.^{4,6-10}

Trois utilisateurs sur quatre préfèrent les bandelettes réactives d'Accu-Chek Aviva, car elles sont plus grandes que la moyenne et donc plus faciles à utiliser.^{1,2}



Accu-Chek FastClix Un seul clic. Point.

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix et sa cartouche de 6 lancettes, unique en son genre, vous permettent de préparer et de changer les lancettes rapidement et simplement sans contact direct.

- 6 lancettes dans une cartouche
- Pas de contact direct avec les lancettes lors du changement de cartouches
- Aucun récipient séparé n'est nécessaire pour les déchets
- Moins de manipulations, donc moins de risques de blessure



Utilisez les 6 lancettes avant de retirer la cartouche. La cartouche usagée se distingue par une bande rouge et ne peut pas être réutilisée.



Vous pouvez régler l'autopiqueur sur 11 profondeurs de piqûre différentes. Vous pouvez ainsi choisir la profondeur de piqûre la moins invasive, quel que soit votre type de peau, pour un prélèvement sanguin quasiment indolore.³




Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.



Le lecteur émet un signal sonore et le symbole  clignote à l'écran lorsque la bandelette réactive a absorbé suffisamment de sang.



Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

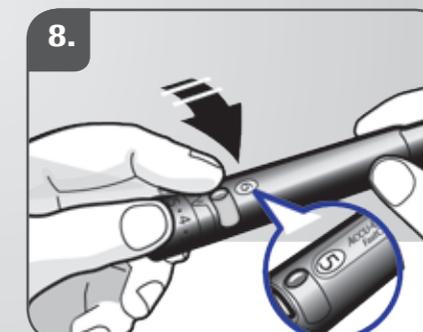

Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en effectuant un aller retour. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

